

Số: 767 /BVQY-TB

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 5 năm 2024

V/v yêu cầu báo giá

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa tại Việt Nam.

Bệnh viện quân y 87/TCHC có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư tiêu hao cho phẫu thuật Phaco.

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện quân y 87/TCHC, 78 Tuệ Tĩnh, Nha Trang, Khánh Hòa.

2. Thông tin của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đinh Văn Tuấn, Chủ nhiệm khoa, 0901972222, dinghtuanhg@gmail.com.

3. Cách tiếp nhận báo giá

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện quân y 87/TCHC, 78 Tuệ Tĩnh, Nha Trang, Khánh Hòa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 04 tháng 5 năm 2024 đến trước 17h ngày 15 tháng 5 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2024.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ


TT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	SL	Thông số kỹ thuật	Địa điểm giao hàng
1	Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu kéo dài tiêu cự	Cái	10	- Chất liệu Acrylic ky nước ,mềm ,trong suốt; Tăng cường thêm tầm nhìn trung gian ,lọc tia UV ; Càng dạng chữ C; Đường kính quang học 6mm; Đường kính tổng 13mm ; Thiết kế 3 điểm cố định ;Góc càng 0° ; Chỉ số khúc xạ 1.47 ; Mặt trước phi cầu ,Chỉ số SA -0.27 μm , Chỉ số ABBE 55 ; Dài độ từ +5D đến 30D. Đạt tiêu chuẩn ISO , CE, FDA	Bệnh viện quân y 87

2	Thủy tinh thể đơn tiêu mềm, một mảnh	Cái	10	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: hợp chất Acrylic (Acrylates) với bề mặt kỵ nước, lọc tia cực tím (UV) và ánh sáng tím (violet light). - Thiết kế: Một mảnh mềm bờ vuông mặt sau 360⁰ liên tục. Kính (optic) 2 mặt lồi, phi cầu mặt sau. Góc càng (Haptic Angulation) 0⁰, càng chữ C. - Kích thước kính: 6.0mm - Chiều dài: 12 mm - Dải công suất: ±0.0D tới +35.0D (1.0D) +15.5D tới +26.5D (0.5D) - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Kích thước vết mổ: ≥ 2.0 mm 	Bệnh viện quân y 87
3	Dao mổ mắt 15 độ	Cái	20	<ul style="list-style-type: none"> - Dao 15 độ cán nhựa - Lưỡi dao thẳng, siêu sắc, hai mặt vát, được mài chính xác, tối ưu để rạch bên và rạch trung tâm của củng mạc và giác mạc. - Lưỡi dao dài 7mm, dày 0.1mm - Góc lưỡi dao 15 độ - Chất liệu lưỡi dao: Thép không gỉ chất lượng cao - Hộp đựng bảo vệ chất liệu Polystyrene 	Bệnh viện quân y 87
4	Dao mổ dùng trong phẫu thuật Phaco	Cái	20	<ul style="list-style-type: none"> Đầu chéo, lưỡi dao phủ satin giảm thiểu phản xạ, lưỡi rộng 2.2-2.8mm Cán dao làm từ Polycarbonate, dài 125 mm, đường kính 6 mm Hộp bảo vệ trong suốt bằng Polycarbonate. 	Bệnh viện quân y 87

5	Dung dịch nhuộm bao dùng trong nhãn khoa OCUBLU-TRY (Trypan Blue 0.06%0.6mg), 1ml	Lo	05 Dung dịch nhuộm bao Trypan Blue nồng độ 0.06%, 0.6 mg/ml trypan blue nguyên chất; 1.9 mg/ml sodium monohydrogen orthophosphate ($\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) 0.3 mg/ml sodium dihydrogen orthophosphate ($\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$); 8.2 mg/ml sodium chloride (NaCl); Nước đẽ bơm pH: 6.5 - 7.2 Độ thẩm thấu: 270-400 mOsm/kg Nội độc tố: ≤ 0.2 EU/mL Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE	Bệnh viện quân y 87
---	---	----	---	---------------------

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TB. T05.

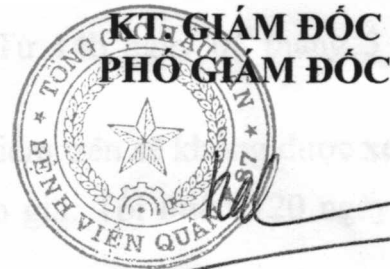

Trung tá Phạm Thị Hạnh